(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 1. September 2005 (01.09.2005)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/079910 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: A61N 1/04, 1/22, 1/24, 1/32

- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/001941
- (22) Internationales Anmeldedatum:

23. Februar 2005 (23.02.2005)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 10 2004 009 210.9


25. Februar 2004 (25.02.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BAUERFEIND AG [DE/DE]; Triebeser Str. 16, 07937 Zeulenroda (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BAUERFEIND, Hans, B. [DE/DE]; Am Oeltsch 5, 07937 Zeulenroda (DE). SCHEUERMANN, Rainer [DE/DE]; Fridjof-Nansen-Strasse 16, 24223 Rainsdorf (DE). REIN-HARDT, Holger [DE/DE]; Margeritenstrasse 153, 47906 Kempten (DE).
- (74) Anwalt: BARDEHLE, Heinz; Bardehle, Pagenberg, Dost, Altenburg, Geissler, Galileiplatz 1, 81679 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: ELASTIC BANDAGE COMPRISING ELECTRODES WHICH ARE ARRANGED AT A DISTANCE FROM EACH OTHER
- (54) Bezeichnung: ELASTISCHE BANDAGE MIT VONEINANDER BEABSTANDETEN ELEKTRODEN

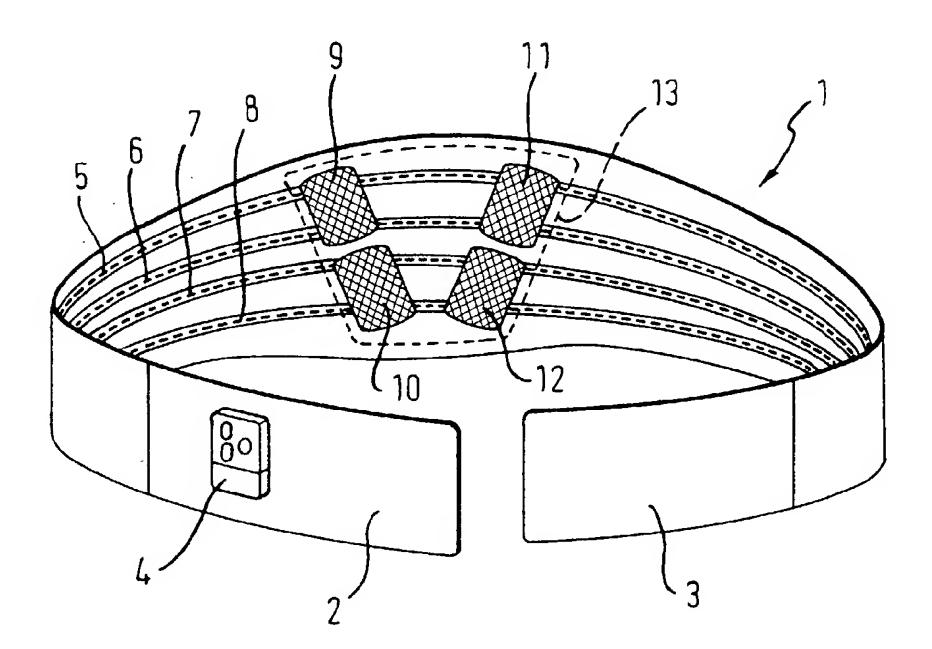

(57) Abstract: The invention relates to an elastic bandage comprising electrodes which are arranged at a distance from each other, and which are to be connected to an electric stimulation device. The elastic region of the bandage supporting the electrodes is covered, on the outer side thereof, by a pocket which is essentially less elastic than the elastic area, and which contains an elastic cushion as a support for the electrodes.



# WO 2005/079910 A1



MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- mit geänderten Ansprüchen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

<sup>(57)</sup> Zusammenfassung: Elastische Bandage mit voneinander beabstandeten Elektroden für den Anschluss an ein elektrisches Stimulationsgerät, wobei der die Elektroden tragende elastische Bereich der Bandage an deren Aussenseite durch eine dem elastischen Bereich gegenüber wesentlich geringer elastische Tasche abgedeckt ist, die ein elastisches Kissen als Abstützung der Elektroden enthält.

#### Elastische Bandage mit voneinander beabstandeten Elektroden

Die Erfindung bezieht sich auf eine elastische Bandage mit voneinander beabstandeten Elektroden für den Anschluss an ein elektrisches Stimulationsgerät.

5

10

15

20

Eine derartige Bandage ist in der WO-Schrift WO 01/02052 A2 beschrieben und dargestellt. In dieser Schrift sind verschiedene Bandagen erläutert, die jeweils auf ihrer der Haut des Trägers zugewandten Seite Elektroden tragen, die aus eingestrickten Leitungsdrähten bestehen und den Berührungskontakt zur Haut herstellen. Das Einstricken der Drähte erfolgt dabei in der Weise, dass z.B. ein Strickmuster verwendet wird, das den Leitungsdrähten die notwendige Längselastizität gibt oder ein Zick-Zack-Stich verwendet wird. Der gesamte Bereich mit den Elektroden weist dabei also die Elastizität auf, die normalerweise von einer Bandage verlangt wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine elastische Bandage mit der eingangs erläuterten Gestaltung zu schaffen, durch die die Effektivität der elektrischen Stimulation wesentlich erhöht wird. Erfindungsgemäß geschieht dies dadurch, dass der die Elektroden tragende elastische Bereich der Bandage an deren Außenseite durch eine dem elastischen Bereich gegenüber wesentlich geringer elastische Tasche abgedeckt ist, die ein elastisches Kissen als Abstützung der Elektroden enthält.

Durch die vorstehend beschriebene Gestaltung des Bereichs der Bandage, der die Elektroden trägt, wird der Anpressdruck der Elektroden gegen die Haut gegenüber dem Anpressdruck einer normalen elastischen Bandage erheblich gesteigert, wodurch die Leitfähigkeit der Berührungsstellen zwischen den Elektroden und der Haut erheblich erhöht wird. Durch die im wesentlichen unelastische Tasche wird die Bandage mit ihrer die Elektroden tragenden Seite gewissermaßen weggedrückt, da sich die Elastizität des Kissens nur in Richtung auf die Haut des Trä-

- 2 -

gers der Bandage auswirken kann. Das sich nach außen hin gegenüber die im wesentlichen unelastische Tasche sich abstützende Kissen drückt nämlich umso stärker gegen die Haut, je fester die Bandage um den betreffenden Körperteil gelegt ist. Dieser erhöhte Druck auf die Haut wirkt sich medizinisch darum besonders günstig aus, weil die sich aufgrund der elektrischen Stimulation ergebenden Muskelkontraktionen von dem elastischen Kissen abgefedert werden, so dass also das elektrische Stimulationsgerät seine Wirkung vor allem im dynamischen Bereich der Benutzung der Bandage voll entfalten kann. Dies gilt natürlich auch für Muskelkontraktionen, die durch normale Bewegungen des betreffenden Trägers der Bandage sich ergeben.

10

15

20

25

30

Um das Stimulationsgerät an die Elektroden anzuschließen, verbindet man das Stimulationsgerät mit den Elektroden zweckmäßig über Leitungsdrähte, die in das Material der Bandage unter Gestaltung einer Vielzahl von aufeinanderfolgenden Biegestellen eingearbeitet sind. Bei diesen Biegestellen kann es sich um die Formgebung aufgrund eines textilen Wirkens oder Strickvorgangs handeln, es ist aber auch z.B. ein Zick-Zack-Stich möglich.

Um das Stimulationsgerät möglichst dicht an den Elektroden anzubringen, befestigt man das Stimulationsgerät zweckmäßig an der Bandage selbst, und zwar lösbar, so dass es jederzeit auch abnehmbar ist.

Für die Füllung des elastischen Kissens gibt es mehrere Möglichkeiten, z.B. elastischer Schaumstoff. Es ist aber auch möglich, das elastische Kissen als aufblasbarer Schlauch zu gestalten, der dann in die Tasche der Bandage eingesteckt ist.

In den Figuren sind Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Figur 1 Eine perspektivische Sicht einer Rückenbandage;

Figur 2 die gleiche Bandage von der Außenseite mit Blick auf die Tasche;

- 3 -

PCT/EP2005/001941

Figur 3 einen Schnitt längs der Linie III-III aus Figur 2;

Figur 4 eine perspektivische Sicht einer Kniegelenkbandage;

5

10

15

**WO 2005/079910** 

Figur 5 einen Schnitt längs der Linie V-V aus Figur 4.

Bei der in der Figur 1 dargestellten Bandage handelt es sich um eine Rückenbandage 1, die mit ihren beiden Enden 2 und 3 am Bauch geschlossen wird, wobei die beiden Enden in üblicher Weise durch einen Klettverschluss miteinander verbunden werden. An dem zu dem Ende 2 weisenden Teil der Rückenbandage 1 ist außen das Stimulationsgerät 4 angebracht, das z.B. mit irgendeiner Schlaufe eingehängt ist. Von dem Stimulationsgerät 4 verlaufen auf der Innenseite der Rückenbandage 1 Leitungsdrähte 5, 6, 7 und 8, die in den auf der Innenseite der Rückenbandage 1 angebrachten Elektroden 9, 10, 11 und 12 enden. Auf der Rückseite der Rückenbandage 1, die also den Elektroden 9 bis 12 abgewandt ist, ist die in der Figur 2 näher beschriebene Tasche 13 angebracht, die in der Figur 1 durch die gestrichelte Linie angedeutet ist.

Die elektrische Versorgung der Elektroden 9 bis 12 erfolgt dabei so, dass die Elektroden 9 und 11 mit dem einen Pol und die Elektroden 10 und 12 mit dem anderen Pol der von dem Stimulationsgerät ausgehenden elektrischen Impulse versorgt werden.

Figur 2 zeigt die gleiche Rückenbandage 1, die hier perspektivisch in einer Lage dargestellt ist, in der sich die beiden Enden 2 und 3 überlappen. Auf der Rückseite der Rückenbandage 1 ist die Tasche 13 befestigt, die aus einem Material besteht, das eine wesentlich geringere Elastizität besitzt als die Elastizität der Rückenbandage 1. Die Tasche 13 enthält hier als elastisches Kissen den Schlauch 14, der gemäß der Formgebung der Tasche 13 trapezförmige Gestalt besitzt und damit die Tasche 13 gut ausfüllt. An dem Schlauch 14 ist in bekannter Weise das Ventil 15

- 4 -

angebracht, über das der Schlauch 14 beliebig stark aufgeblasen werden kann, wobei sich folgender Effekt ergibt: Da die Tasche 13 wegen ihrer weitgehenden Unelastizität sich nicht ausdehnen kann, zwingt die Ausdehnung des Schlauches 14 das über der Tasche 13 befindliche Material der Rückenbandage 1, sich in Richtung auf den Rücken des Trägers auszudehnen und sich damit je nach Stärke des Aufblasens des Schlauches 14 mit entsprechend eingestelltem Druck gegen die Haut des Trägers zu pressen. Hierdurch wird der Übergangswiderstand von den dadurch angepressten Elektroden 9, 10, 11 und 12 (gemäß Figur 1) zu der Haut des Trägers entsprechend herabgesetzt, womit sich die Intensität der Auswirkung der vom Stimulationsgerät ausgehenden Impulse entsprechend einstellen lässt.

5

10

15

20

25

30

In der Figur 3 ist ein Schnitt gemäß der Linie III-III aus Figur 2 dargestellt, in dem die besondere Gestaltung des Schlauches 14 gezeigt ist. Der Schlauch 14 wird über das Ventil 15 aufgeblasen, wobei sich das Material der Bandage 1 von der Tasche 13 wegdrückt und damit die Elektroden 9 und 10 gegen die Haut des Trägers der Bandage presst.

In der Figur 4 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel für die Anwendung eines elektrischen Stimulationsgerätes mit einem elastischen Kissen dargestellt, bei dem es sich um eine Kniegelenkbandage 16 handelt. Im Bereich des oberen Randes der Kniegelenkbandage 16 ist das Stimulationsgerät 4 eingehängt. Von diesem führen die beiden Leitungsdrähte 17 und 18 zu den Elektroden und sind dabei so geführt, dass der Leitungsdraht 17 zu den beiden oberen Elektroden 19 und 20 führt und der Leitungsdraht 18 an den beiden unteren Elektroden 21 und 22 angeschlossen ist. Daher ergibt sich bei dieser Gestaltung ein Potentialgefälle immer in Längsrichtung des Knies, also von der Elektrode 19 zur Elektrode 21 und von der Elektrode 20 zur Elektrode 22. Die Elektroden 19, 20, 21 und 22 sind wie beim Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 auf der Innenseite der Kniegelenkbandage 16 angebracht. Auf der Außenseite der Kniegelenkbandage im Bereich der Elektroden 19 bis 22 ist die Tasche 23 befestigt, die in der gleichen Weise wirkt, wie die

- 5 -

im Zusammenhang mit den Figuren 1 und 2 beschriebene Tasche 13. Im Unterschied zum Ausführungsbeispiel gemäß den Figuren 1 und 2 ist hier die Tasche 23 mit einem elastischen Schaumstoff gefüllt, der über die Elektroden 19 und 22 den notwendigen Druck auf die Haut ausübt.

5

10

In der Figur 5 ist ein Schnitt längs der Linie V-V aus Figur 4 dargestellt, der die Anbringung der Tasche 23 an dem Material der Bandage 16 zeigt. Zwischen der Tasche 23 und dem Material der Bandage 16 ist das aus Schaumstoff bestehende elastische Kissen 24 eingebracht, das den notwendigen Druck auf die auf dem Material der Bandage 16 angebrachten Elektroden 19 und 21 ausübt. Bei angelegter Kniegelenkbandage 16 drücken dann die Elektroden 19 und 21 auf die Haut des Trägers und vermitteln damit die Wirkung der elektrischen Stimulation aus dem Stimulationsgerät 4.

Es sei darauf hingewiesen, dass als elastisches Material für das elastische Kissen auch andere elastische Materialien verwendet werden können, die von ihren Eigenschaften her in der Lage sind, nachgiebig einen Druck auf die betreffenden Elektroden auszuüben.

20

25

- 6 -

#### Patentansprüche

- 1. Elastische Bandage (1, 16) mit voneinander beabstandeten Elektroden (9, 10, 11, 12; 19, 20, 21, 22) für den Anschluss an ein elektrisches Stimulationsgerät (4), dadurch gekennzeichnet, dass der die Elektroden (9, 10, 11, 12; 19, 20, 21, 22) tragende elastische Bereich der Bandage (1, 16) an deren Außenseite durch eine dem elastischen Bereich gegenüber wesentlich geringer elastische Tasche (13, 23) abgedeckt ist, die ein elastisches Kissen (14, 24) als Abstützung der Elektroden (9, 10, 11, 12; 19, 20, 21, 22) enthält.
  - 2. Bandage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Stimulationsgerät (4) mit den Elektroden (9, 10, 11, 12; 19, 20, 21, 22) über Leitungsdrähte (5, 6, 7, 8; 17, 18, 19, 20) verbunden ist, die in das Material der Bandage (1, 16) unter Gestaltung einer Vielzahl von aufeinander folgenden Biegestellen eingearbeitet sind.
  - 3. Bandage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Stimulationsgerät (4) an der Bandage (1, 16) lösbar befestigt ist.
  - 4. Bandage nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das elastische Kissen (24) mit elastischem Schaumstoff gefüllt ist.
- 5. Bandage nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das elastische Kissen aus einem aufblasbarem Schlauch (14) besteht.

15

20

# GEÄNDERTE ANSPRÜCHE

[beim Internationalen Büro am 11. Juli 2005 (11.07.05) eingegangen; ursprünglicher Anspruch 1 durch neuen Anspruch 1 ersetzt; alle weiteren Ansprüche unverändert (1 Seite)]

# Patentansprüche

5 1. Elastische Bandage (1, 16) mit voneinander beabstandeten Elektroden (9, 10, 11, 12; 19, 20, 21, 22) für den Anschluss an ein elektrisches Stimulationsgerät (4), dadurch gekennzeichnet, dass der die Elektroden (9, 10, 11, 12; 19, 20, 21, 22) tragende elastische Bereich der Bandage (1, 16) an deren Außenseite durch eine dem elastischen Bereich gegenüber wesentlich geringer elastische Tasche (13, 23) abgedeckt ist, die ein elastisches Kissen (14, 24) als Abstützung der auf der Innenseite der Bandage (1, 16) angebrachten Elektroden (9, 10, 11, 12; 19, 20, 21, 22) enthält.

Fig. 1

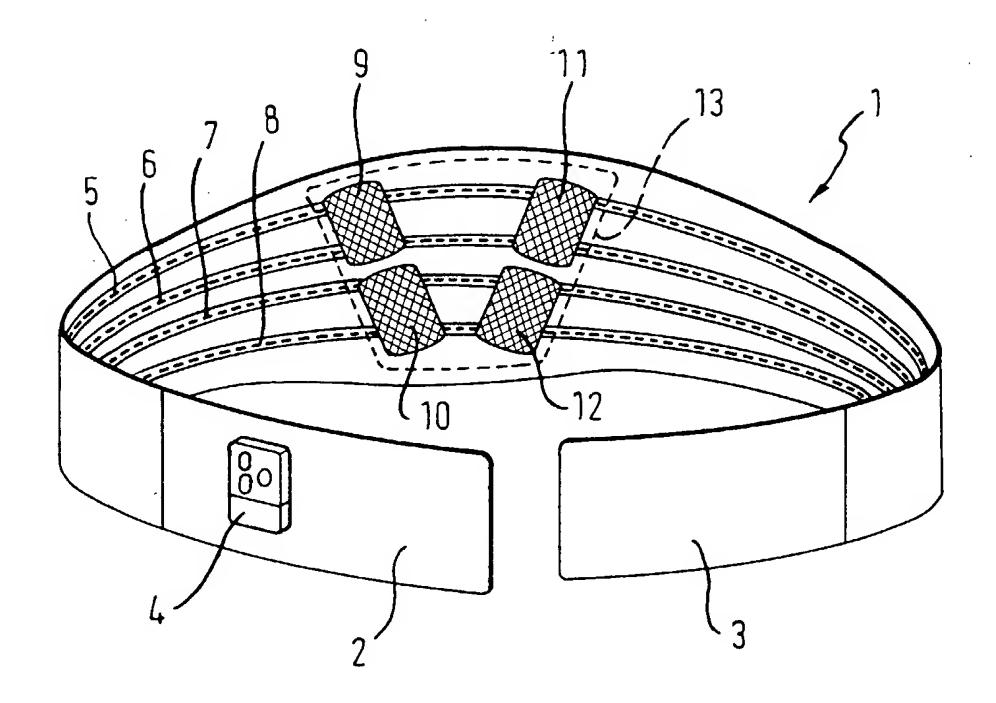


Fig. 2



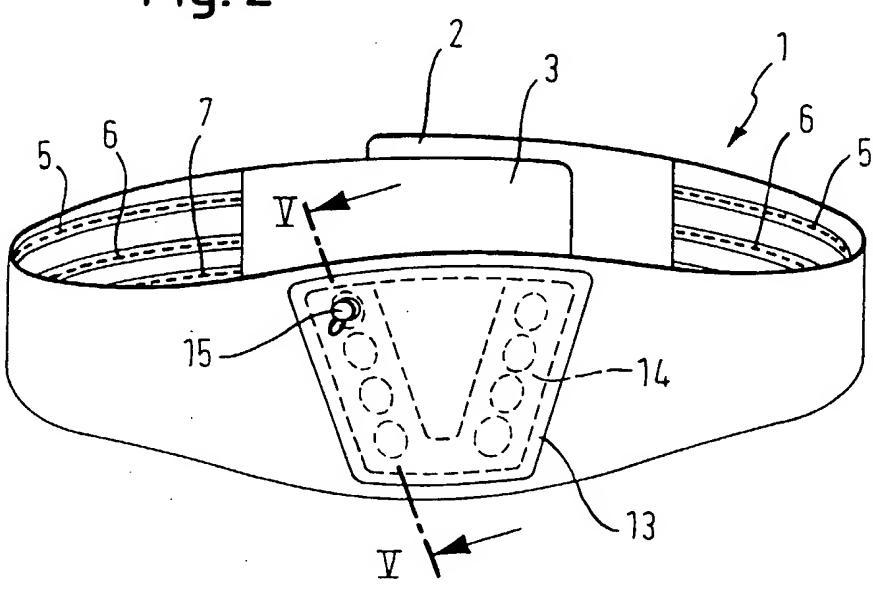


Fig. 3

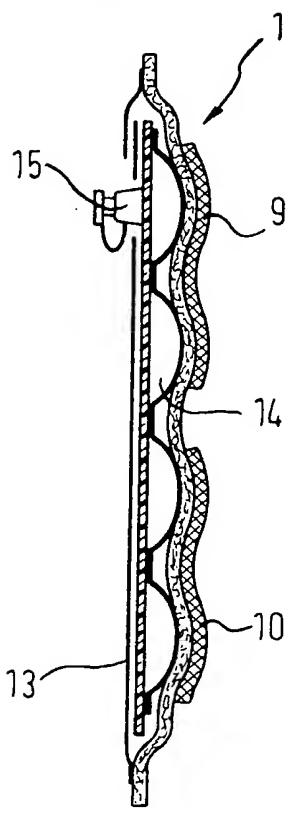

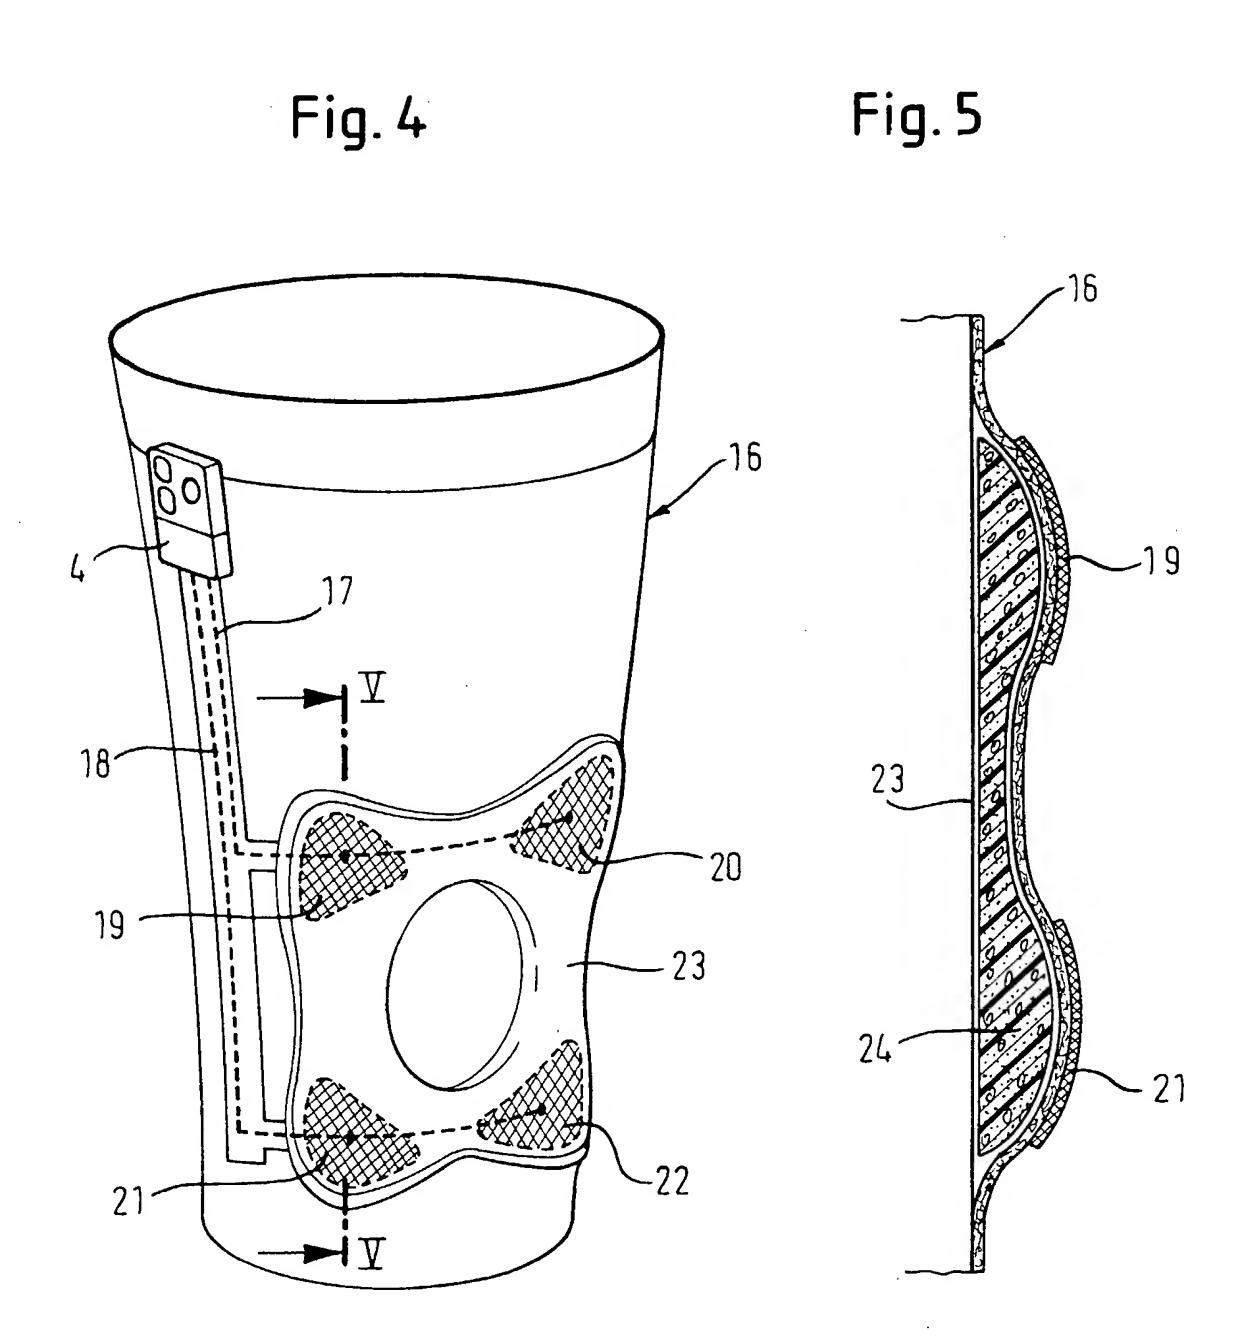

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internation No PCT/EP2005/001941

A. CLASSI IPC 7	A61N1/04 A61N1/22 A61N1/	/24 A61N1/32	
A coording to	a International Patent Classification (IDC) arts both national class	oification and IDC	
	o International Patent Classification (IPC) or to both national class	Silication and IPC	<del></del>
	ocumentation searched (classification system followed by classification sy	ication symbols)	
Documental	tion searched other than minimum documentation to the extent th	nat such documents are included in the fields so	earched
Electronic d	ata base consulted during the international search (name of data	a base and, where practical, search terms used	)
EPO-In	ternal		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	e relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 948 972 A (LIFECOR, INC) 13 October 1999 (1999-10-13) paragraph '0015!; claim 1; figu	ıre 6	1
X	CH 213 343 A (BENOIT-NICOLET, AF 31 January 1941 (1941-01-31) the whole document	RNOLD)	1
E	US 2005/049515 A1 (MISCZYNSKI E ET AL) 3 March 2005 (2005-03-03 paragraph '0019!; figure 2a		1
Α	WO 01/02052 A (N.V. BEKAERT S.A EMMANUEL; HEIRBAUT, GUIDO; VAN STEENLANDT,) 11 January 2001 (2 the whole document		1-5
		-/	
X Furth	her documents are listed in the continuation of box C.	χ Patent family members are listed i	n annex.
° Special ca	itegories of cited documents :	*T* later document published after the inte	rnational filing date
consid	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention  "X" document of particular relevance; the c	the application but eory underlying the
filing d	late ent which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the do	be considered to
which citation	is cited to establish the publication date of another n or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an involvement is combined with one or mo	laimed invention ventive step when the
other r "P" docume		ments, such combination being obvious in the art.  *&* document member of the same patent.	us to a person skilled
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing of the international sea	rch report
3	1 May 2005	07/06/2005	
Name and n	nailing address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Chopinaud, M	

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/EP2005/001941

_		PCT/EP2005/001941				
C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT						
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.				
A	EP 0 339 471 A (LIFECOR, INC.) 2 November 1989 (1989-11-02) abstract	1-5				
!						

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

mormation on patent family members

Internal all Application No PCT/EP2005/001941

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0948972	Α	13-10-1999	US CA EP	6065154 A 2266784 A1 0948972 A2	23-05-2000 07-10-1999 13-10-1999
CH 213343	Α	31-01-1941	NONE		
US 2005049515	A1	03-03-2005	NONE	—	
WO 0102052	Α	11-01-2001	AU WO	5530900 A 0102052 A2	22-01-2001 11-01-2001
EP 0339471	A	02-11-1989	US CA DE DE EP JP JP US	4928690 A 1321814 C 68927898 D1 68927898 T2 0339471 A2 1320069 A 2791095 B2 5078134 A	29-05-1990 31-08-1993 30-04-1997 16-10-1997 02-11-1989 26-12-1989 27-08-1998 07-01-1992

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP2005/001941

A. KLASSI   IPK 7	ifizierung des anmeldungsgegenstandes A61N1/04 A61N1/22 A61N1/24	4 A61N1/32					
Nach de <u>r In</u>	iternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	assifikation und der IPK					
	RCHIERTE GEBIETE						
Recherchie	rter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol A61N	ole )					
	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	·					
	Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)  EPO-Internal						
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN						
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweil erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.				
X	EP 0 948 972 A (LIFECOR, INC) 13. Oktober 1999 (1999-10-13) Absatz '0015!; Anspruch 1; Abbild	dung 6	1				
X	CH 213 343 A (BENOIT-NICOLET, ARNO 31. Januar 1941 (1941-01-31) das ganze Dokument	)LD)	1				
E	US 2005/049515 A1 (MISCZYNSKI DAL ET AL) 3. März 2005 (2005-03-03) Absatz '0019!; Abbildung 2a	_E JULIAN	1				
A	WO 01/02052 A (N.V. BEKAERT S.A; EMMANUEL; HEIRBAUT, GUIDO; VAN STEENLANDT,) 11. Januar 2001 (200 das ganze Dokument		1-5				
		-/					
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie					
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</li> <li>A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegen Theorie angegeben ist</li> <li>"V" Veröffentlichung von besonderer Bedeutungs die begenzenschte Erfindung zugrundeliegen der Prinzips oder der ihr zugrundeliegen der Prinzips oder d</li></ul>							
"L" Veröffer schein andere soll od	"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie  *Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Enfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet Enfinderischer Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Enfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet						
"O" Veröffe eine Be "P" Veröffer	"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist						
	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Red	cherchenberichts				
3	1. Mai 2005	07/06/2005					
Name und P	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter					
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Chopinaud, M					


### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interponales Aktenzeichen
PCT/EP2005/001941

C.(Fortsetzı	ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	PC1/E1 2005/001941
Kategorie <sup>o</sup>	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Beti	racht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
4	EP 0 339 471 A (LIFECOR, INC.) 2. November 1989 (1989-11-02) Zusammenfassung	1-5

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören



	Recherchenbericht artes Patentdokumen	t	Datum der Veröffentlichung	ľ	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP	0948972	A	13-10-1999	US CA EP	6065154 2266784 0948972	A1	23-05-2000 07-10-1999 13-10-1999
CH	213343	Α	31-01-1941	KEINE			
US	2005049515	A1	03-03-2005	KEINE			
WO	0102052	Α	11-01-2001	AU WO	5530900 0102052		22-01-2001 11-01-2001
EP	0339471	A	02-11-1989	US CA DE DE DE EP JP JP US	0339471	C D1 T2 A2 A B2	29-05-1990 31-08-1993 30-04-1997 16-10-1997 02-11-1989 26-12-1989 27-08-1998 07-01-1992